

# Mepitel® One

Nouvelle couche de contact avec la plaie dotée de la technologie Safetac®


## Filet en polyuréthane

- La structure à mailles ouvertes permet un transfert libre de l'exsudat de la plaie vers le pansement externe absorbant, ainsi que l'application de préparations topiques sur la plaie<sup>11-13</sup>
- Transparence élevée
- Mince et adaptable pour le confort optimal du patient et une adhésion solide Couche Safetac®

## Couche Safetac®

- Diminue les douleurs et les traumatismes avant, pendant et après le changement des pansements<sup>9</sup>
- Se scelle sur le bord de la plaie afin de réduire le risque de macération<sup>10</sup>
- Adhère délicatement à la peau sèche et intacte, sans se coller au lit humide de la plaie

**SafetaC**  
TECHNOLOGIE

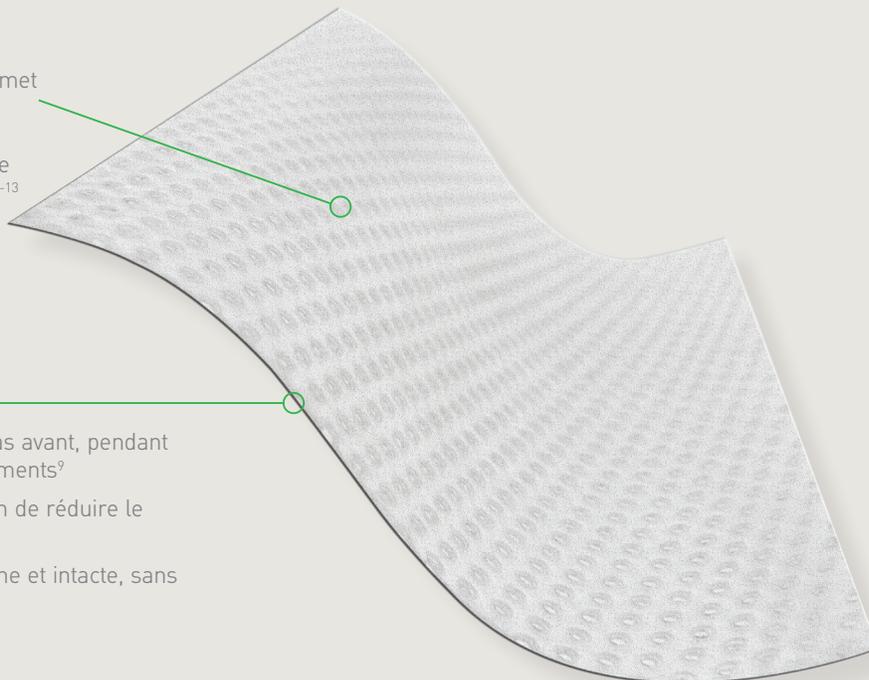

- Minimise la douleur et le trauma lors du changement des pansements<sup>1,2</sup>
- Peut rester en place pendant une période maximale de 14 jours<sup>3-7</sup>, ce qui permet une guérison économique<sup>1,8</sup> et sans interruption des plaies

- Surface extérieure non adhérente offrant une adaptabilité, une souplesse et une facilité d'application optimales

## Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac\*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde<sup>1-3</sup>.


\* A unique proprietary technology exclusive to Mölnlycke Health Care

**SafetaC**  
TECHNOLOGIE


Mepitel® One

  
Mölnlycke®


## Application de Mepitel One

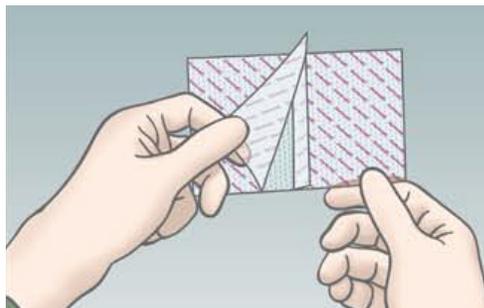

Nettoyez soigneusement la zone de la plaie, et séchez la peau autour de la plaie. Enlevez la pellicule anti-adhésive.

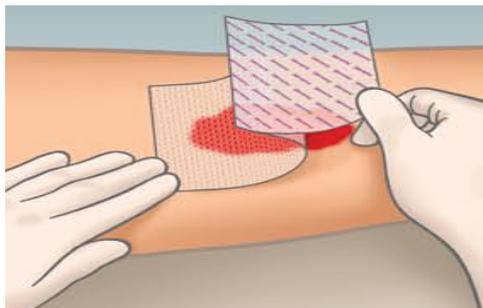

Appliquez Mepitel One sur la plaie, en laissant recouvrir la peau péri-lésionnelle sur 2 cm.

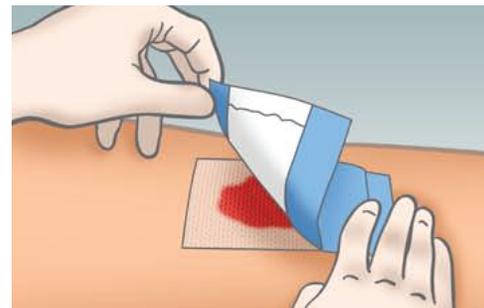

Appliquez un pansement extérieur absorbant tel que Mesorb et fixez-le.

## Mode d'action de Mepitel® One

Mepitel One peut rester en place pendant une période maximale de 14 jours<sup>3-7</sup>, selon l'état de la plaie. La structure poreuse de Mepitel One permet à l'exsudat de passer dans un pansement extérieur absorbant. La surface de contact avec la plaie Safetac protège la plaie et la zone péri-lésionnelle et empêche le pansement extérieur de coller à la plaie. La couche Safetac se scelle également sur le bord de la plaie, ce qui empêche les fuites d'exsudat sur la peau autour de la plaie, minimisant de ce fait le risque de macération. Mepitel One est mince, transparent et est doté d'une surface extérieure lisse et non adhérente permettant une adaptabilité, une souplesse et une facilité d'utilisation optimales.

## Avantages de Mepitel® One

- Minimise les douleurs et les traumatismes lors du changement des pansements.
- Peut rester en place pendant une période maximale de 14 jours, ce qui permet une guérison économique et sans interruption des plaies
- Minimise le risque de macération
- Maintient son intégrité au fil du temps; ne s'assèche pas et ne laisse aucun résidu lors de l'enlèvement
- Transparent pour une inspection facile de la plaie dans le cadre de l'application et du port
- S'adapte bien aux formes du corps, ce qui favorise le confort du patient qui le porte et améliore l'adhésion

## Indications\*

Mepitel® One est un pansement interface indiqué dans le traitement de nombreuses plaies exsudatives telles que : les plaies douloureuses, les déchirures cutanées, les dermabrasions, les plaies chirurgicales, les brûlures du deuxième degré, les lésions traumatiques, les phlyctènes, les lacérations, les greffes totales ou partielles, les radiodermites, les ulcères de jambe ou de pied. Il peut-être utilisé également comme protection pour les plaies non exsudatives ou sur les zones de peaux fragiles.

## Sélection Mepitel® One (emballage stérile)

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
289100	5 x 7,5	10	70
289300	7,5 x 10	10	40
289500	10 x 18	10	70
289700	17 x 25	5	40
289750	27,5 x 50	2	14

\*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site [www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

### Références:

1. Gotschall CS, et al. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. *Journal of Burn Care & Rehabilitation* 1998;19(4):279-283.
2. Bugmann Ph, et al. A silicone-coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. *Burns* 1998;24:607-612.
3. Eagle M. Use of non-adherent silicone dressing Mepitel to meet client centered needs in chronic non-healing wounds. *Clinical Report Mölnlycke Health Care* (1998).
4. Taylor R. Use of a silicone net dressing in severe mycosis fungoides. *JoWC*, Vol 8, No 9 (1999), p.429-430.
5. Young T. Fungating wounds: their diagnosis and management. *Community nurse*, 5, No 10 (1999), p. 53-54.
6. Marconi R, Laverda F, Trevisan G. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, 2009.
7. Barraziol R, Fracalenta E, Schiavon M. Poster Presentation European Wound Management Association, Helsinki, Finland, 2009.
8. Rippon M, Davies P, White R, Bosanquet N. Cost implications of using an atraumatic dressing in the treatment of acute wounds. *Jo WC*, vol 17, No 5 (2008), p. 224-7.
9. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. *J Wound Care* 2001; 10(2):7-10.
10. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritation and skin barrier function. *J Wound Care* 2007, 16(3):97-100.
11. Dahlstrom KK. *Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg* 1995;29 (4):325-7.
12. Vloemans AFPM, Kreis RW. *Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Hand Surgery* 1994;28:75-6.
13. Lapioli-Zufelt A, Morris EJ. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing* 1998;25(6):314-6.

Mölnlycke  
1-800-494-5134  
[www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13090, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.  
Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care, Mepitel®One, et Safetac® sont déposés partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.  
© 2017 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

## Précautions\*

- Conformément aux pratiques cliniques en vigueur, la plaie: doit être examinée afin de repérer tout signe d'infection. En cas de signes cliniques, consulter un médecin pour un traitement approprié.
- Mepitel One peut être utilisé sur les patients atteints d'épidermolyse bulleuse, après avis d'un professionnel de santé qualifié.
- S'il est utilisé sur une brûlure du deuxième degré à haut risque de granulation rapide ou après resurfaçage facial : éviter toute pression sur le pansement, soulever et repositionner le pansement au moins tous les deux jours.
- Lorsqu'il est utilisé sur des plaies hémorragiques ou sur des plaies présentant un exsudat de viscosité élevée : le pansement Mepitel One doit être recouvert d'un pansement secondaire humide.
- Lorsqu'il est utilisé sur les fixations de greffes de peau, le pansement Mepitel One ne doit pas être changé dans les 5 jours qui suivent sa pose.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser en cas de détérioration du sachet ou ouverture antérieure à l'utilisation. Ne pas re-stériliser.

## Avertissements

- Mepitel One présente un degré d'adhésion supérieur à celui de Mepitel. En utilisant Mepitel One chez les patients atteints d'épidermolyse bulleuse, faites preuve de prudence et soyez attentif lors du changement des pansements.
- Lorsque Mepitel One est utilisé sur les brûlures traitées au moyen de greffes en filet, évitez d'exercer une pression inutile sur le pansement. Des empreintes peuvent se produire si le produit n'est pas utilisé convenablement.
- Lorsque Mepitel One est utilisé à la suite d'un changement de pansement sur le visage, évitez d'exercer une pression inutile sur le pansement, et soulevez et repositionnez le pansement tous les deux jours au minimum. Des empreintes peuvent se produire si le produit n'est pas utilisé convenablement.



  
**Mölnlycke®**

CFWC00601905